

Wałbrzych 14.10.2010 r.

DZPZ-530-Zp/90/PN-78/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy przetarg nieograniczony na dostawy obłożeń – Zp/90/PN-78/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo o wymiarach 140 cm x 80 cm. Powyższy wymiar jest zgodny z wymogami znormalizowanymi wymiarów stołu Mayo i spełnienia wszystkie wymagania związane z łatwą aplikacją i zdejmowaniem osłony po zabiegu operacyjnym?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakiet nr 2, poz. 2 – zestaw do laparoskopii

Mając na względzie możliwość zaoferowania konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji poniższy skład zestawu:

- serweta z wbudowanymi osłonami na nogi, samoprzylepnymi oknami: w części kroczonej 9 cm x 12 cm osłonięty klapką, w części brzusznej 25 cm x 30 cm, serweta o wymiarach 200 cm x 265 cm – 1 szt.,
- przezroczysta torba na narzędzia – nie zintegrowana z serwetą, możliwość umiejscowienia w dowolnym miejscu,
- serweta na stół Mayo 140 cm x 80 cm – 1 szt. – powyższy wymiar jest zgodny z wymogami znormalizowanych wymiarów stołu Mayo i spełnia wszystkie wymagania związane z łatwą aplikacją i zdejmowaniem osłony po zabiegu operacyjnym,
- serweta na stół instrumentalny min. 190 x 150 cm – 1 szt.,
- serwetki celulozowe min. 4 szt.

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. parametrów włókniny z której wykonane obłożenie operacyjne opisane w Pakiecie 2,3,4,5,6,7

Prosimy o informację, czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie włókniny laminowanej dwuwarstwowej, której parametry przewyższają wartość włókniny trójwarstwowej wskazane w SIWZ? W związku z faktem, iż we wspomnianej normie EN 13795(1-3) nie pojawia się wymóg określenia wytrzymałości na rozciąganie w stanie suchym i mokrym w kierunkach poprzecznym i podłużnym jak również w trosce o możliwie najlepsze spełnienie wymogów stawianych przed obłożeniami pola operacyjnego w zakresie parametrów poszczególnych komponentów oraz w dbałości bezpieczeństwa personelu wykonującego zabiegi operacyjne zwracamy się z prośbą o dopuszczenie naszych wyrobów, przewyższających we wszystkich ocenianych kryteriach parametry jakościowe zamieszczone w SIWZ w w/w pakiecie:

Wskazana w SIWZ wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym w kierunku podłużnym min.67,0N, w kierunku poprzecznym min.26,0N. **Wytrzymałości na rozciąganie w stanie suchym naszych wyrobów: 75 N.**

Wskazana w SIWZ wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym w kierunku podłużnym min.58,0 N, w kierunku poprzecznym min.25,0 N. **Wytrzymałości na rozciąganie w stanie mokrym naszych wyrobów: 75 N.**

Odp. Nie

Pytanie 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2,3,4,5,7 zestawów operacyjnych zawiniętych w serwetę stanowiącą jednocześnie okrycie stolika instrumentariuszki. W trosce o środowisko naturalne, od dłuższego czasu zawinięcie wszystkich naszych zestawów obłożeń pola operacyjnego stanowi serweta na stół instrumentariuszki. Dodatkowo takie pakowanie zestawu znacznie ułatwia aplikację obłożenia na bloku operacyjnym

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakietu nr 3, poz. 1,2,3,4 , pakiet nr 4, poz. 1, pakiet 5, poz. 1, pakiet nr 7, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 140 cm x 80 cm. Powyższy wymiar jest zgodny z wymogami znormalizowanych wymiarów stolika Mayo i spełnia wszystkie wymagania związane z łatwą aplikacją i zdejmowaniem osłony po zabiegu operacyjnym

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakiet nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w zestawie możliwość zaoferowania worka do przechwytywania płynów nie zintegrowanego z serwetą ale zapakowanego łącznie z całym zestawem, worek wyposażony w dwa otwory otoczone taśmą neoprenową? Dołączony osobno worek do przechwytywania płynów w znacznym stopniu ułatwia aplikację serwety na pacjencie, dopasowanie operowanej kończyny do otworu i swobodne doklejenie worka do przygotowanego na pacjencie obłożenia.

Lub jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o wyłączenie z Pakietu nr 3, pozycji nr. 3 do odrębnego Pakietu. Podział Pakietu umożliwi naszej firmie złożenie alternatywnej oferty, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty.

Odp. Nie

Pytanie 7, dot. pakiet nr 7, poz. 1

Mając na względzie możliwość zaoferowania konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji poniższy skład zestawu:

- serweta zabiegowa 150x192 cm, zintegrowana z nogawicami, posiada w części kroczonej otwór o średnicy 5cm i otwór w części brzusznej o średnicy 6cm przysłonięty dodatkowym zabezpieczeniem i osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Dookoła otworu warstwa chłonna 22x22cm. Do obłożenia dołączona torba do przechwytywania płynów z sitem oraz podłączenie do drenów o średnicy 8mm – 1 szt.
- serweta na stolik Mayo o wymiarach 140 cm x 80 cm – 1 szt.
- taśmy medyczne mocujące 10 cm x 50 cm – 3 szt.
- ręczniki celulozowe – 4 szt.

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakiet nr 7, poz. 2

Mając na względzie możliwość zaoferowania konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji poniższy skład zestawu:

- serweta 200 x 75 cm z otworem 8 cm x 12 cm – 1 szt.
- serweta 90 cm x 75 cm – 1 szt. – bez zmian
- serweta 180 cm x 150 cm na stół instrumentarium – 1 szt.
- serweta na stolik Mayo o wymiarach 140 cm x 80 cm – 1 szt.
- pokrowce na kończyny dolne pacjenta 120 cm x 70 cm – 2 szt.
- ręczniki celulozowe 30 cm x 30 cm – 4 szt.

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakiet nr 9, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji nr 10 z pakietu nr 9? Wyodrębnienie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu umożliwi zwiększenie ilości i jakości ofert oraz zaoferowanie Zamawiającemu zestawu spełniającego rygorystyczne wymagania wysoko wyspecjalizowanych procedur okulistycznych różniących się koniecznymi parametrami od pozostałych pozycji w/w pakietu

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakiet nr 9, poz. 10

Mając na względzie możliwość zaoferowania konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji poniższy skład zestawu:

- serweta okulistyczna niewchłaniałna, przepuszczalna dla powietrza, gwarantująca komfort dla pacjenta podczas zabiegu, o wymiarach 100 cm x 100 cm, folia do nacięcia o wymiarach 15 cm x 27 cm, otwór 10x10cm, torebka na płyny pooperacyjne w wymiarach 25 cm x 26 cm i pojemności powyżej 250 ml z plastikowymi kształtami zintegrowanymi z serwetą umożliwiającymi modelowanie serwety podczas zabiegu
 - knot odprowadzający wykonany ze 100% bawełny i celulozy gwarantujący wysoką chłonność i skuteczne przechwytywanie wszelkich drobin z pola operacyjnego
- Materiał: Niepyląca włóknina trójwarstwowa typu SMS o gr. 51g/m². Odporność na przenikanie cieczy 51 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie 92 N, wytrzymałość na wypychanie 109 Kpa

Odp. Nie

Pytanie 11, dot. pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii z czterema otworami w następującym składzie:

- 1 serweta do angiografii 240 x 340 cm, z dwoma otworami o rozmiarze 7 x 10 cm i dwoma otworami o rozmiarze 5 x 7 cm wykonana z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m²; nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa, folia obustronnie,
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm,
- 1 fartuch chirurgiczny Protect open back XL,

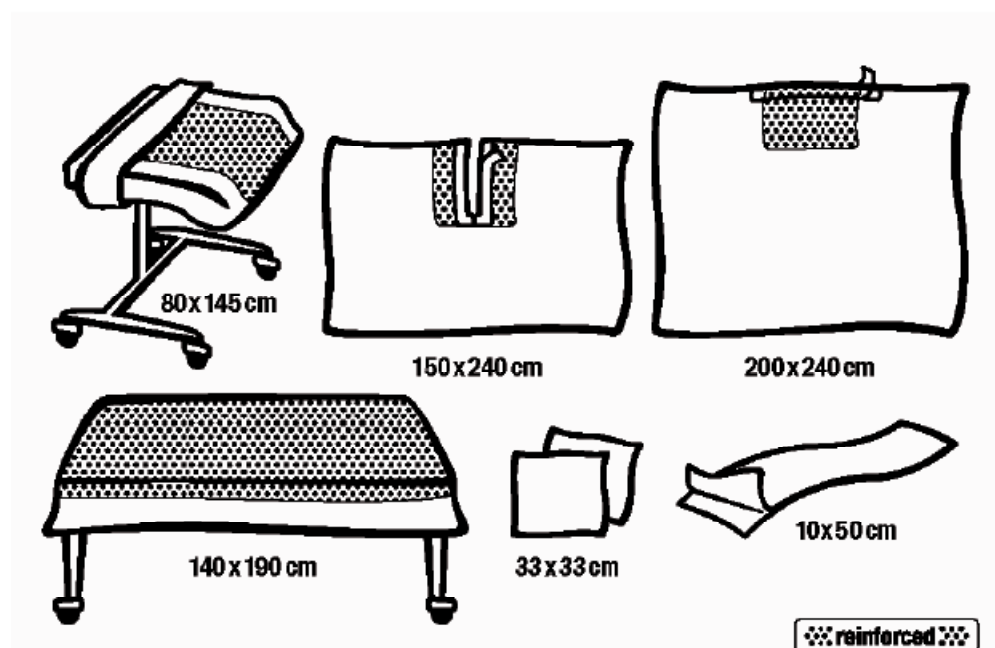
- 1 osłona na sprzęt 55 x 40 cm,
- 1 osłona na sprzęt 102 x 102 cm,
- 1 serweta Protect na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 150 cm x 200 cm wykonana z dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 54 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 75 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 30 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 75 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 30 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa?

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji tarczycy wykonanego z miękkiego dwuwarstwowego materiału z obszarami wzmocnionymi o gramaturze 55 g/m²; obszar wzmocnień 110 g/m²; nieprzemakalność > 150 cm H₂O dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych, wytrzymałość na rozciąganie na sucho oraz na mokro > 45 N/50 mm obszary niewzmocnione i > 110 N/50 mm obszary wzmocnione, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro > 150 kPa obszary niewzmocnione i > 300 kPa obszary wzmocnione i następującym składzie:

Miejsca



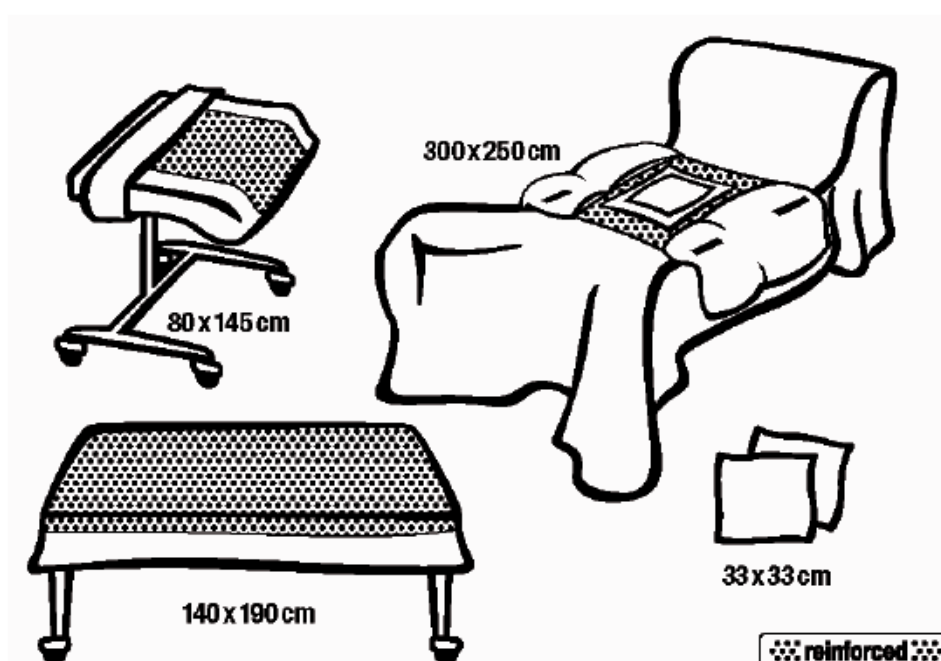
wykropkowane – obszary wzmocnione

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm),
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm),
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 240 cm; wycięcie „U” 6,5 x 60 cm (wzmocnienie 70 x 60 cm),
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm),
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm,
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ?

Odp. Nie

Pytanie 13, dot. pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii w ułożeniu ginekologicznym ze zintegrowanymi osłonami na kończyny wykonanego z miękkiego dwuwarstwowego materiału z obszarami wzmocnionymi o gramaturze 55 g/m²; obszar wzmocnień 110 g/m²; nieprzemakalność > 150 cm H₂O dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych, wytrzymałość na rozciąganie na sucho oraz na mokro > 45 N/50 mm obszary niewzmocnione i > 110 N/50 mm obszary wzmocnione, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro > 150 kPa obszary niewzmocnione i > 300 kPa obszary wzmocnione i następującym składzie:



Miejsca

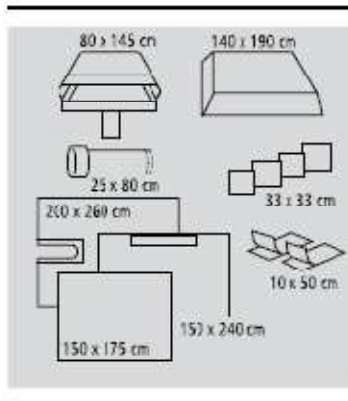
wykropkowane – obszary wzmocnione

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm),
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm),
- 1 serweta do zabiegów laparoskopii 300 x 250 cm (okno 28 x 32 cm),
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm?

Odp. Nie

Pytanie 14, dot. pakiet 3, poz. 1

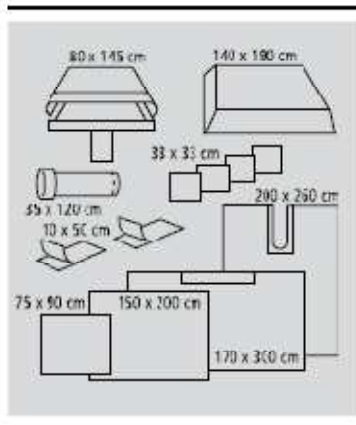
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu barkowego wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do artroskopii stawu barkowego 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 osłona na kończyne 1 serweta operacyjna (pocład pod kończyne) 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U (6,5 x 60 cm) 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 2 taśmy samoprzylepne 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 25 x 80 150 x 175 200 x 260 150 x 240 10 x 50 33 x 33
---	---	---

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m^2 , nieprzemakalność $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$ i następującym składzie:

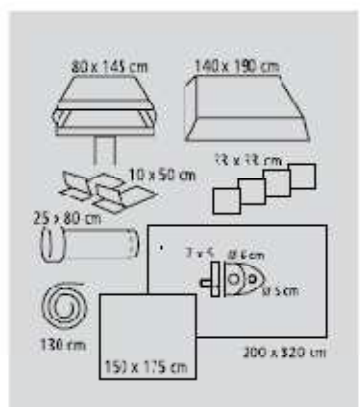
	Foliodrape® Zestaw II do zabiegów w chirurgii biodra 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta operacyjna 1 serweta operacyjna 1 osłona na kończyne 1 serweta samoprzylepna 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U (6,5 x 95 cm) 2 taśmy samoprzylepne 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 75 x 90 150 x 200 35 x 120 170 x 300 200 x 260 10 x 50 33 x 33
--	---	---

Oraz dodatkowo, pakowana oddzielnie (niezależnie od zestawu) jednosekcyjna kieszeń samoprzylepna o rozmiarze $43 \text{ cm} \times 38 \text{ cm}$?

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakiet 3, poz. 3

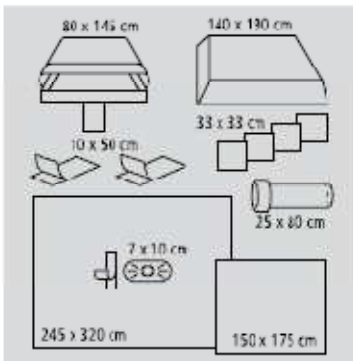
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m^2 , nieprzemakalność $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$ i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do artroskopii 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta nieprzylepna (pod nogę) 1 osłona na kończyne 1 serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów. Posiada samouszczelniające się, elastyczne otwory; $7 \times 5 \text{ cm}$, $\varnothing 5 \text{ cm}$ 1 rurka drenowa 2 taśmy samoprzylepne 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 150 x 175 25 x 80 200 x 320 130 10 x 50 33 x 33
---	--	---

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakiet 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Follodrape® Zestaw III do zabiegów na kończynie	
	1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta nieprzyklepna (podkład pod kończynę) 1 osłona na kończynę 1 serweta do obłożenia kończyny z elastycznym, samo- uszczelniającym się otworem (Ø 7 x 10 cm) i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów 2 taśmy samoprzylepne 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 150 x 175 25 x 80 245 x 320 10 x 50 33 x 33

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do neurochirurgii 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta do obłożenia czaszki z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (19 x 30 cm) i torbą do zbierania płynów (z sitem i zaworem) 2 samoprzylepne serwety operacyjne (do ograniczenia wielkości pola operacyjnego, jeśli wymagane) 2 uchwyty Velcro do mocowania kabli i drenów 1 taśma samoprzylepna 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 245 x 320 50 x 50 2 x 23 10 x 50 33 x 33
--	---	---

Odp. Tak

Pytanie 19, dot. pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m^2 , nieprzemakalność $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$ i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw Uniwersalny I 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta operacyjna 2 samoprzylepne serwety operacyjne 1 samoprzylepna serweta operacyjna 1 samoprzylepna serweta operacyjna 1 taśma samoprzylepna 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 75 x 90 75 x 90 170 x 175 150 x 240 10 x 50 33 x 33
--	---	---

Odp. Tak

Pytanie 20, dot. pakiet 6, poz. 1,6,7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m^2 , nieprzemakalność $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$?

Odp. Nie

Pytanie 21, dot. pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo w rozmiarze $145 \text{ cm} \times 80 \text{ cm}$ wykonanej z dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 57 g/m^2 (folia); 93 g/m^2 (folia + włóknina); 134 g/m^2 (folia + wzmocnienia) nieprzemakalność $> 150 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 110 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 45 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym

70 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 40 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa ?

Odp. Nie

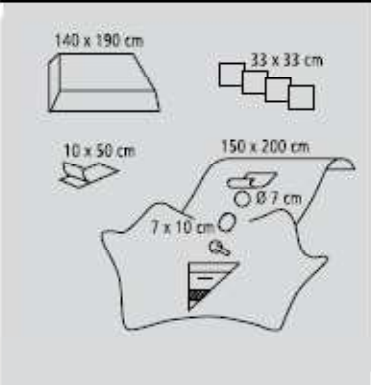
Pytanie 22, dot. pakiet 6, poz. 4,5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na kończynę wykonanego z dwuwarstwowego materiału (włóknina/folia) o gramaturze 70 g/m², nieprzemakalność > 150 H₂O, odporność na rozciąganie na sucho oraz mokro w kierunku podłużnym 60N/50 mm, w kierunku poprzecznym 50N/50mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho > 100 kPa, na mokro > 50 kPa ?

Odp. Nie

Pytanie 23, dot. pakiet 7, poz. 1

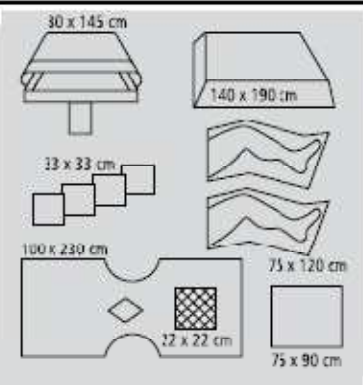
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji urologicznych ze zintegrowanymi osłonami na kończyny wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O , wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do urologii	
	1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta urologiczna z nadłonowym samoprzylepnym okienkiem (Ø 7cm), z samoprzylepnym oknem na narządy płciowe (7 x 10 cm), osłoną na palec i torbą do zbierania płynów (z sitem) 1 taśma samoprzylepna 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 150 x 200 10 x 50 33 x 33

Odp. Tak

Pytanie 24, dot. pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O , wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do procedur przezcewkowych (TUR)	
	1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta operacyjna 1 serweta z oknem (8 x 12 cm) i sitem (22 x 22 cm) 2 osłony na nogi długie 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 75 x 90 100 x 230 75 x 120 33 x 33

Odp. Tak

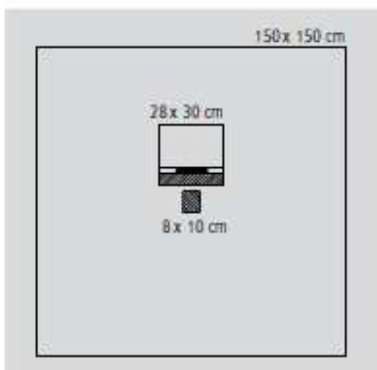
Pytanie 25, dot. pakiet 9, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni samoprzylepnej dwusekcyjnej o rozmiarze 43cm x 38cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26, dot. pakiet 9, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji zaćmy wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O , wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw okulistyczny Serweta okulistyczna z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8 x 10 cm) i kieszenią na płyny (28 x 30 cm)	150 x 150
--	---	-----------

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 10 i utworzenie dla niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27, dot. pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie zestawów z dwiema serwetami z przylepcem o wymiarach 90 x 70 (ad. pkt. 3 opisu) i serwetą na stół Mayo o wymiarze 140 x 80 cm (ad pkt. 5 opisu). Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 28, dot. pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie zestawów z serwetą na stół Mayo o wymiarach 140 x 80 cm z oddzielnie pakowaną taśmą medyczną mocującą i dwoma serwetkami celulozowymi. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 29, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenia pola operacyjnego w pakiecie 2 z włókniny trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina wiskozowa) spełniającej pozostałe wymagania?

Odp. Tak

Pytanie 30, dot. pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta z otworem trapez i przylepcem	1	L3	320x180	TRAPEZ	28x20x19
serweta	1	L3	160x90		

Odp. Nie

Pytanie 31, dot. pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenia pola operacyjnego w pakiecie 3 z włókniny trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina wiskozowa) spełniającej pozostałe wymagania?

Odp. Tak

Pytanie 32, dot. pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie, spełniający pozostałe parametry?

serweta z wycięciem U i przylepcem	1	L3	260x180
serweta z przylepcem	1	L3	240x180
pokrowiec na kończynę górną pacjenta	1	L3	90x25
serweta pod kończynę górną pacjenta	1	L3	180x150
taśma medyczna	2	L2	50x10
serweta na stół instrum.	1	Medicace 4	180x140
serweta na stolik Mayo	1	PE/wiskoza	145x80
serwetki do rąk	4	celuloza	50x40

Odp. Tak

Pytanie 33, dot. pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z jedną serwetą na stół instrumentalny, spełniający pozostałe wymagania?

Odp. Tak

Pytanie 34, dot. pakiet 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii z serwetą min. 320x 180cm z otworem elastycznym samouszczelniającym się o śr. min. 6 cm z workiem na płyny, spełniający

pozostałe wymagania? Jeżeli nie prosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu, pozwoli to na złożenie większej liczby ofert i podwyższy konkurencyjność postępowania?

Odp. Tak

Pytanie 35, dot. pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści obłożenia pola operacyjnego w pakiecie 4 z włókniny trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina wiskozowa) spełniającej pozostałe wymagania?

Odp. Tak

Pytanie 36, dot. pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie, spełniający pozostałe wymagania?

serweta z otworem,workiem na płyny i folią chir.	1	L3	240x180	PROST.	25x20
serweta z przylepcem	2	L3	60x45		
serweta	1	L3	180x150		
kieszek dwukomorowa z kształtką	1	L2	30x25		
kieszek na płyny z kształtką	1	L2	40x30		
taśma medyczna	2	L2	50x10		
serweta na stół instrum.	1	Medicace 4	180x140		
serweta na stolik Mayo	1	PE/wiskoza	145x80		
serwetki do rąk	4	celuloza	50x40		

Odp. Tak

Pytanie 37, dot. pakiet 6

Czy Zamawiający odstąpi od parametrów (pod tabelą) zawartych w pakiecie nr 6, są one nieadekwatne do wyszczególnionego asortymentu?

Odp. Nie

Pytanie 38, dot. pakiet 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową bez przylepca spełniającą pozostałe wymagania lub serwetę z dwuwarstwowej foliowanej włókniny wiskozowo-polietylenowej o gramaturze min. 59 g/m² z przylepcem spełniającą pozostałe wymogi?

Odp. Nie

Pytanie 39, dot. pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści obłożenia pola operacyjnego w pakiecie 7 z włókniny trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina wiskozowa) spełniającej pozostałe wymagania?

Odp. Tak

Pytanie 40, dot. pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z

- serwetą 90 x 80cm w miejsce 90 x 75cm,
- taśmą 90 x 10cm w miejsce 90 x 7cm,
- serwetą na stolik mayo 145 x 80 w miejsce 145 x 85cm?

Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odp. Tak

Pytanie 41, dot. pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z

- serwetą 90 x 80cm w miejsce 90 x 75cm,
- pokrowcem na kończyny dolne 120x60cm w miejsce 120x 67cm,
- serwetą na stolik mayo 145 x 80 w miejsce 145 x 85cm
- ręcznikami celulozowymi 50x40cm w miejsce 50x43cm?

Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odp. Tak

Pytanie 42, dot. pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści obłożenia pola operacyjnego w pakiecie 8 z włókniny laminowanej dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) spełniającej pozostałe wymagania?

Odp. Tak

Pytanie 43, dot. pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem chirurgicznym F-4/XL z lejem zamiast prześcieradła z lejem?

Odp. Tak

Pytanie 44, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 **Obłożenie do operacji tarczycy** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- Serweta do operacji tarczycy T-kształtna (196/254x307 cm), otwór w kształcie diamentu wykończony taśmą samoprzylepną (13x13 cm), 3 organizatory przewodów?

Odp. Nie

Pytanie 45, dot. pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 **Zestaw do laparoskopii** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- Serweta do laparoskopii (198/259x307 cm), T-kształtna, otwór wykończony taśmą samoprzylepną (25x28 cm), z dwiema kieszeniami na narzędzia, wzmocnienie absorpcyjne, 4 organizatory przewodów?

Odp. Nie

Pytanie 46, dot. pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 **Zestaw do operacji stawu barkowego** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
 - Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
 - Serweta (102x150 cm),
 - Serweta z wcięciem (200x274 cm), wcięcie (6x94 cm) wykończone taśmą samoprzylepną, z warstwą absorpcyjną,
 - Serweta górna wykończona taśmą samoprzylepną, z warstwą absorpcyjną (183x300 cm),
- 1 organizator przewodów?

Odp. Nie

Pytanie 47, dot. pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 **Zestaw do operacji stawu barkowego** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- Serweta do operacji ramion z kieszenią (168x254 cm), otwór w kształcie gruszki wykończony taśmą samoprzylepną, z warstwą absorpcyjną,
- Serweta do operacji ramion z wcięciem (196x290 cm), wcięcie (25x64 cm), wykończona taśmą samoprzylepną, z warstwą absorpcyjną, 2 organizatory przewodów?

Odp. Nie

Pytanie 48, dot. pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 **Zestaw do operacji stawu biodrowego** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
 - Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
 - Serweta (102x150 cm),
 - Serweta z wcięciem (200x274 cm), wcięcie (6x94 cm) wykończone taśmą samoprzylepną, z warstwą absorpcyjną,
 - Serweta górna wykończona taśmą samoprzylepną, z warstwą absorpcyjną (183x300 cm),
- 1 organizator przewodów?

Odp. Nie

Pytanie 49, dot. pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 **Zestaw do operacji stawu biodrowego** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
 - Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
 - Serweta do operacji biodra z wbudowanymi dwiema kieszeniami na narzędzia i płyny (226/284x348 cm), T-kształtna, elastyczny otwór wykończony taśmą samoprzylepną,
- 3 organizatory przewodów?

Odp. Nie

Pytanie 50, dot. pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 **Zestaw do artroskopii kolana nr 1** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- 2 x Taśma, Eclipse, 10x50 cm,
- Ochraniacz na nogę w kształcie skarpety (23x91 cm),
- Serweta do artroskopii T-kształtna ze zbiornikiem na płyny w kształcie stożkowego worka z sitem oraz zaworem do pomiaru płynów (229/290x310 cm), elastyczny otwór średnicy 6 cm, 3 organizatory przewodów?

Odp. Nie

Pytanie 51, dot. pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 **Zestaw do artroskopii kolana nr 2** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- Serweta (135x152 cm),
- Taśma, SMS, 10x50 cm,
- Ochraniacz na nogę w kształcie skarpety (23x91 cm),
- Serweta do operacji kończyn (229x328 cm), elastyczny otwór średnicy 6 cm, z warstwą absorpcyjną, 4 organizatory przewodów?

Odp. Nie

Pytanie 52, dot. pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 **Zestaw do kraniotomii** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- Serweta do kraniotomii (254x264 cm), owalny otwór (28x20 cm) ze wzmocnieniem i ze zbiornikiem w kształcie stożkowego worka z sitem oraz zaworem do pomiaru płynów, warstwa absorpcyjna, 1 organizator przewodów?

Odp. Tak

Pytanie 53, dot. pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 **Obłożenie uniwersalne** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- 2 Serwety boczne z warstwą absorpcyjną i taśmą samoprzylepną (75x93 cm),
- Serweta dolna z warstwą absorpcyjną i taśmą samoprzylepną (175x183 cm),
- Serweta górna z warstwą absorpcyjną i taśmą samoprzylepną (152x250 cm)?

Odp. Tak

Pytanie 54, dot. pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 **Obłożenie do operacji urologicznych** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- Serweta do T.U.R. (150/240x255 cm), serwety ochronne na nogi, wzmocnienie absorpcyjne (zapobiegające zsuwaniu się narzędzi), otwór cewnikowy, otwór perinatalny z osłoną na palec?

Odp. Tak

Pytanie 55, dot. pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 **Obłożenie do operacji cystoskopii** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (112x193 cm),
- Ręcznik chłonny,
- 2 Serwety ochronne na nogi (74x109 cm),
- Serweta do cystoskopii T-kształtna (89/152x221 cm), otwór 8x18 cm z warstwą absorpcyjną, wzmocnienie absorpcyjne (zapobiegające zsuwaniu się narzędzi), 2 organizatory przewodów?

Odp. Tak

Pytanie 56, dot. pakiet 9

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania poz. 1-6, co pozwoli na złożenie ofert większej licznie wykonawców?

Odp. Nie

Pytanie 57, dot. pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 **Obłożenie jałowe uniwersalne** w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- 2 Serwety boczne z warstwą absorpcyjną i taśmą samoprzylepną (75x93 cm),
- Serweta dolna z warstwą absorpcyjną i taśmą samoprzylepną (175x183 cm),
- Serweta górna z warstwą absorpcyjną i taśmą samoprzylepną (152x250 cm)?

Odp. Nie

Pytanie 58, dot. pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 Obłożenie jałowe do zabiegów twarzowo-czaszkowych w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- Serweta na głowę Turban (102x69 cm) wykończona taśmą samoprzylepną,
- Serweta z wcięciem (96x279 cm), wcięcie (9x61 cm), wykończona taśmą samoprzylepną, z warstwą absorpcyjną, serweta na narzędzia?

Odp. Nie

Pytanie 59, dot. pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 Obłożenie jałowe do zabiegów w chirurgii otolaryngologicznej w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),
- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),
- Serweta na głowę Turban (102x69 cm) wykończona taśmą samoprzylepną,
- Serweta z wcięciem (96x279 cm), wcięcie (9x61 cm), wykończona taśmą samoprzylepną, z warstwą absorpcyjną, serweta na narzędzia?

Odp. Nie

Pytanie 60, dot. pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 Jałową serwetę włókninową, dwuwarstwowa, nieprzylepną o rozmiarze 45x50cm?

Odp. Nie

Pytanie 61, dot. siwz

Czy Zamawiający uzna za spełniający warunek zawarty w pkt. IV (Wymagania od Wykonawców) wykaz dostaw na sprzęt medyczny (łóżka szpitalne, materace do łóżek, wózki do transportu chorych)? Prośba podyktowana jest faktem, iż sprzedają materiałów jednorazowego użytku zajmujemy się od niedawna i nie możemy wykazać się zrealizowanymi, zakończonymi dostawami (pełnymi) na tego typu sprzęt. Posiadamy natomiast bogate doświadczenie w dostawach sprzętu medycznego różnego zastosowania. Nasza firma jest w trakcie realizacji umów na dostawy podkładów do porodu jednorazowego użytku, jednak nie może przedstawić referencji potwierdzających należyte wykonanie, a jedynie protokoły wykonanych dostaw częściowych

Odp. Nie

Pytanie 62, dot. pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety głównej o wymiarze 230 x 350 cm z dwoma otworami fi 8,5 oraz dwoma otworami o wymiarach 6 x 12 cm?

Odp. Nie

Pytanie 63, dot. pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji tarczycy wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 60g/m² zgodnie z normą EN 13795 (1-3) o składzie:

- a) serweta o wym.150x200 cm z wycięciem U o wym. 10x50 cm wykończonym taśmą samoprzylepną;
- b) serweta 180x220cm z taśmą lepłą;
- c) pokrowiec na stół Mayo 79x145cm;
- d) dwie ściereczki chłonne 30x40cm;
- e) taśma samoprzylepna włókninowa 9x49cm;
- f) dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40 na ssak i koagulację;
- g) serweta o wym. 150x200cm stanowiąca owinięcie zestawu, która może służyć jako przykrycie na stół instrumentalny?

Odp. Nie

Pytanie 64, dot. pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do laparoskopii ginekologicznej wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 60g/m² zgodnie z normą EN 13795 (1-3) o składzie:

- a) serweta podstawowa 180x270cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym, w części centralnej serwety znajduje się otwór 20x30x20cm otoczony taśmą lepłą, w części kroczonej otwór 10x15 wraz z przykrywającą go klapką 20x20cm;
- b) pokrowiec na stół Mayo 79x145cm;

- c) taśma samoprzylepna 9x49cm;
- f) kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 2x15x40cm;
- g) serweta o wym. 150x200cm stanowiąca owinięcie zestawu, która może służyć jako przykrycie na stolik instrumentalny?

Odp. Nie

Pytanie 65, dot. pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji stawu barkowego wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 60g/m² zgodnie z normą EN 13795 (1-3) o składzie:

- a) serweta 150 x 200cm z wycięciem U o wym. 10 x 50cm wykończonym taśmą samoprzylepną,
- b) serweta 180 x 220cm z taśmą lepną,
- c) osłona na kończynę o wym. 37 x 75cm,
- d) pokrowiec na stolik Mayo o wymiarze 79x145cm,
- e) taśma lepna o wym. 9 x 49cm,
- f) dwie ściereczki chłonne 30 x 40cm,
- g) serweta o wym. 150 x 180cm stanowiąca owinięcie zestawu, która może służyć jako przykrycie stolika?

Odp. Nie

Pytanie 66, dot. pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji stawu biodrowego wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 60g/m² zgodnie z normą EN 13795 (1-3) o składzie:

- a) serweta o wym. 200x290cm z wycięciem w kształcie litery U (9 x 100cm), otoczonym taśmą samoprzylepną,
- b) serweta o wym. 150x240 cm. służąca jako ekran anestezjologiczny,
- c) serweta na stolik Mayo 79 x 145cm,
- d) dwie ściereczki celulozowe,
- e) kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 2 x 15 x 40cm,
- f) pokrowiec na kończyne o wym. 37x105cm,
- g) trzy taśmy lepne 9 x 49cm,
- h) serweta 150x200cm stanowiąca owinięcie zestawu, która służy jako pokrycie stolika?

Odp. Nie

Pytanie 67, dot. pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do artroskopii kolana wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 60g/m² zgodnie z normą EN 13795 (1-3) o składzie:

- a) serweta główna o wym. 220x320cm wyposażona w warstwę chłonna i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 7cm, dodatkowo serweta zintegrowana jest z workiem przechwytyującym płyny, która również posiada samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 6cm.
- b) osłona na kończynę o wym. 37 x 75cm
- c) dwie taśmy lepne 9 x 49cm do mocowania osłony kończyny.
- d) dwa ręczniki chłonne .

- e) osłona na stół MAYO 79x145cm.
- f) dren 100 cm.
- g) serwetka 150x180cm stanowiąca owinięcie zestawu która służy jako przykrycie stołu?

Odp. Nie

Pytanie 68, dot. pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania sterylnej zestawu do artroskopii kolana wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 60g/m² zgodnie z normą EN 13795 (1-3) o składzie:

- a) serwetka główna o wymiarach 220x320cm, wyposażona w warstwę chłonna i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 7cm, który szczelnie przylega powyżej kolana.
- b) osłona na kończynę o wym. 37 x 75cm
- c) dwie taśmy lepne 9x49cm do mocowania osłony kończyny.
- d) osłona na stół MAYO 79x145cm.
- e) ręczniki wysokochłonne - 4szt.
- f) serwetka o wym. 150x200cm stanowiąca owinięcie zestawu, które służy jako przykrycie stołu narzędziowego?

Odp. Nie

Pytanie 69, dot. pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania sterylnej zestawu do kraniotomii wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 60g/m² zgodnie z normą EN 13795 (1-3) o składzie:

- a) serwetka główna o wym. 180x240cm posiadająca otwór 20 x 25cm wypełniony folią chirurgiczną, jak te_ wyposażona dodatkowo w długi worek do odprowadzania płynów,
- b) dwie serwetki o wym. 50x60cm wykończone taśmami lepnymi, służące do zabezpieczenia headrestu,
- c) sterylne serwetki na stół Mayo o wym. 79cm x 145cm,
- d) kieszeń przylepna 30 x 30cm na gaziki,
- e) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 30cm na ssak i koagulację,
- f) dwie ściereczki chłonne,
- g) dwie taśmy przylepne 9 x 49cm,
- h) serwetka o wym. 150x200 cm stanowiąca owinięcie zestawu, służąca jako przykrycie stołu?

Odp. Nie

Pytanie 70, dot. pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy mocującej o tolerancji wymiarów +-1cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odp. Nie

Pytanie 71, dot. pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy o wymiarze 9x49cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odp. Nie

Pytanie 72, dot. pakiet 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o wymiarze 150x240cm?
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odp. Tak

Pytanie 72, dot. pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji urologicznych o składzie:

obłożenie do procedur Tur o wymiarze 75x175cm z dwoma otworami o wymiarach 8 i 6 cm oraz osłoną na palec do badania per rectum,

2 osłony na kończyny 75x120cm,

1 taśma lepna o wymiarze 9x49cm,

1 serweta na stolik o wymiarze 150x190cm mogąca służyć jako przykrycie stolika do instrumentarium.

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się na oddzielnie pakowane i dostarczane serwety na stolik Mayo o wymiarze 79x145cm?

Odp. Tak

Pytanie 73, dot. pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji cystoskopii o składzie:

1 serweta o wymiarze 75x175cm z otworem o wymiarze 9x15cm,

2 osłony na kończynę o wymiarach 75x120cm,

1 serweta na stolik o wymiarze 150x190cm służąca jako przykrycie stolika na instrumentarium.

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się na oddzielnie pakowane i dostarczane serwety na stolik Mayo o wymiarze 79x145cm?

Odp. Tak

Pytanie 74, dot. pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji prostaty wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 60g/m² zgodnie z normą EN 13795 (1-3) o składzie:

a) obłożenie do przezcewkowych zabiegów urologicznych wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, o wymiarach 150 x 240cm, zintegrowane z nogawicami, posiadające otwór na pręcie 5 x 7cm, jak też osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Dokoła otworów warstwa chłonna 35 x 40cm. Do obłożenia zamocowana jest torba przechwytyjąca płyny z sitem (filtrem) i podłączeniem drenu.

b) nieprzemakalny fartuch do zabiegów endoskopowych,

c) serweta o wymiarze 150x200cm,

d) przewód drenażowy 8mm/140cm,

e) serweta 150 x 180cm, która może służyć jako przykrycie stolika na instrumentarium.

Odp. Tak