



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 04.10.2011 r.

DZPZ-530-Zp/80/PN-70/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu i urządzeń medycznych – Zp/80/PN-70/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający w dopuści pakiecie nr 2 poz. 2 Kosz do kontenerów o wymiarach 540x253x106 mm?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni dla pakietu 4 od dnia podpisania umowy lub inny stosownie dłuższy od wymaganego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakietu 4 : Lampa operacyjna LED sufitowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwugłowicową, w której obydwie głowice są identyczne i posiadają takie same parametry? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 5000 K? Parametr ten jest wyraźnie korzystniejszy od wymaganego i podnosi wartość użytkową lampy, zwiększając jej możliwości zastosowawcze.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia oświetlenia mieszczącą się w przedziale od 10% do 100%? Przyjęte rozwiązanie jest znacznie lepsze od



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746


www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

wymaganego, ponadto proponowana lampa posiada zintegrowane oświetlenie endoskopowe, w związku z czym nie ma konieczności aby lampa posiadała szerszy zakres regulacji natężenia oświetlenia.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której średnica pola bezcieniowego regulowana jest w zakresie 250-380mm zarówno dla czaszy głównej jak i satelitarnej? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, przystosowaną do zainstalowania kamery na dodatkowym ramieniu, co jest rozwiązaniem znacznie lepszym, pozwalającym na uzyskanie obrazu z dowolnej strony, bez znaczenia aktualnego położenia lampy? Oferowana lampa w części centralnej posiada wbudowany układ sterowania sensorowego, który uniemożliwia umieszczenie w tym miejscu kamery, co jednak nie wpływa na funkcjonalność całego układu.

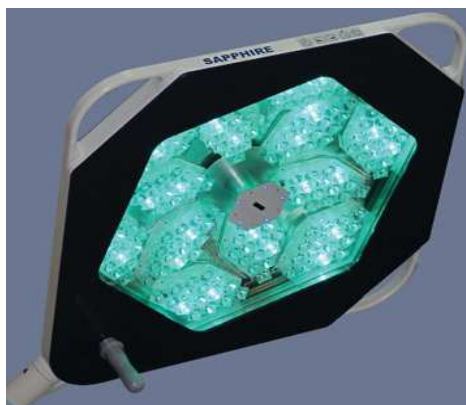

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampę operacyjną z jednym panelem sterowania umieszczonym na brzegu czaszy oraz dodatkowo za pomocą innowacyjnego systemu wbudowanych sensorów, pozwalającego na bezdotykowe sterowanie jej funkcjami? Oferowane rozwiązanie podnosi komfort pracy personelu medycznego, który może sterować funkcjami lampy w sposób całkowicie sterylny, bardziej precyzyjny i szybszy.

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu 4 : Lampa operacyjna jednoczasowa – statywowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której natężenie oświetlenia wynosi 140 kLux? Oferowana wartość różni się od wymaganej w niewielkim stopniu i zapewnia pełną funkcjonalność lampy.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której odtworzenie barwy światła słonecznego wynosi 93? Oferowana wartość różni się od wymaganej w niewielkim stopniu i zapewnia pełną funkcjonalność lampy.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której średnica pola bezcieniowego regulowana jest w zakresie 160-250mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której przedział roboczy bez konieczności ogniskowania wynosi 104cm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, wyposażoną w system awaryjnej żarówki o takich samych parametrach jak żarówka główna, natomiast bez systemu jej automatycznego przemieszczania? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której moc pobierana przez główne źródło światła wynosi 150W? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Ponieważ Norma IEC 60601-2-41 nie precyzuje pojęcia żywotność żarówki a jedynie stabilność parametrów, co prowadzi do podawania przez niektórych producentów zawyżonych danych dotyczących tzw. żywotności żarówki (żarówka świeci do 5 – 6 tys. godzin, ale z niższą wydajnością) czy Zamawiający dopuści żywotność gwarantowaną żarówek 1000 h oraz dodatkową żarówkę jako zapas na dodatkowy okres eksploatacji

Odp. Nie