



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 16.01.2012 r.

DZPZ-530-Zp/7/PN-5/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego oraz videokolonoskopu – Zp/7/PN-5/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty zawarcia umowy lub na inny stosownie dłuższy zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, dlatego proces jego produkcji może zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odp. Nie

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1%? Proponowane kary umowne są bardzo wysokie biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego i podnosi wartość użytkową stołu.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w trzy podwójne koła o średnicy 125mm, blokowany na czas zabiegu przez hydraulicznie wysuwane nóżki,



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

aktywowane przy pomocy przewodowego pilota? Wskazane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego, zapewnia jednak pełną mobilność stołu i jego całkowite unieruchomienie na czas zabiegu.

Odp. Nie



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego blat składa się z 6-segmentów: podgłówek, płyta plecowa górna i dolna, płyta siedzeniowa dwuczęściowa i czteroczęściowy podnóżek dzielony wzdłużnie i poprzecznie? Wskazane rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym jest równie korzystne jak oczekiwane i zapewnia pełną wartość użytkową stołu.





ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego całkowita szerokość blatu wynosi 550mm, natomiast z szynami 615mm? Wskazany parametr jest równie korzystny jak wymagany i pozwala na swobodne przeprowadzanie zabiegów pacjentom o większym obwodzie ciała.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w specjalne, zdejmowane materace o dwuwarstwowej strukturze, w których górna warstwa wykonana jest z tworzywa viscoelastic, które dopasowuje się do wymiarów pacjenta pod wpływem jego temperatury o wysokości 75mm mocowane do stołu za pomocą specjalnych wpustów? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i zdecydowanie podnosi komfort operowanego oraz ułatwia pracę personelu medycznego.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny bez możliwości montażu poszczególnych segmentów blatu z włókna węglowego? Oferowany stół wyposażony jest w blaty wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, istnieje natomiast możliwość montażu dodatkowych przystawek (np. podpórki ręki) z włókna węglowego, rozwiązanie to jest równie korzystne jak wymagane i gwarantuje pełną funkcjonalność stołu podczas przeprowadzania różnych zabiegów chirurgicznych.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym i sterowaniem elektrycznym za pośrednictwem dwóch przewodowych pilotów – głównego i awaryjnego – identycznego jak pilot główny zamiast wymaganego panelu sterowania na kolumnie? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze od wymaganego dodatkowego panelu sterowania na kolumnie, gdyż w przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół” co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu. Ponadto obydwa piloty posiadają te same funkcje oraz piktogramy. Współgrają ze sobą, gdy wciśniemy jakiś przycisk na jednym pilocie to sygnalizator diodowy aktywacji danej funkcji zapala się również na drugim



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

pilocie. Jednak, ze względów bezpieczeństwa, w danym momencie można korzystać tylko z jednego pilota, nie ma możliwości sterowania funkcjami stołu z dwóch pilotów jednocześnie, co w zupełności realizuje wymaganą funkcję zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem.



Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, którego pilot wskazuje następujące informacje o poziomie naładowania akumulatorów: bateria naładowana (zielony LED), ładowanie baterii, podłączony kabel zasilający (żółty LED), bateria rozładowana (czerwony LED)? Wskazane rozwiązanie jest tożsame z oczekiwanym.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w standardowe wejście USB 2.0 umożliwiające podłączenie komputera i przeprowadzenie diagnostyki stołu bez podłączenia z systemami Zintegrowanej Sali Operacyjnej? Przyjęte rozwiązanie w pełni realizuje wymaganą funkcję.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego zakres regulacji wysokości wynosi 650-1010mm? Parametr drugi jest korzystniejszy od wymaganego, natomiast pierwszy mimo, iż minimalnie odbiega od wymaganego i zapewnia optymalny komfort pracy chirurgów o zróżnicowanym wzroście, zarówno niższym jak i wyższym.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, z możliwością regulacji przechyłów bocznych w zakresie $\pm 17^\circ$? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ponadto większe nachylenie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746


www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

spowodowałyby zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzania zabiegów.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, wyposażony w zdejmowany podgłówek, w którym regulacja położenia kąтового realizowana jest od -58° do $+26^{\circ}$ z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i zapewnia pełną funkcjonalność stołu, a dodatkowa możliwość wysuwu podgłówka poszerza możliwości zastosowania stołu.

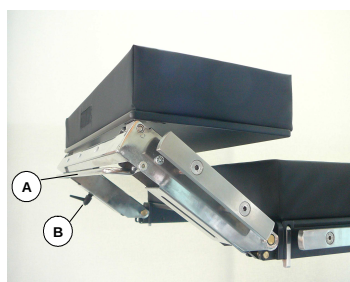

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu podnóżków w zakresie $\pm 90^{\circ}$ (górze-dół) oraz dodatkowo przy pomocy sprężyny gazowej od -90° do $+10^{\circ}$? Wskazane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i pozwala na pełne wykorzystanie stołu w praktyce użytkowej, ponadto gdy zajdzie potrzeba podnóżki można rozsunąć na boki każdy o 90° lub też całkowicie zdjąć.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny, w którym jednoczesna regulacja dwuczęściowego oparcia pleców odbywa się w przedziale od -35° do $+70^{\circ}$? Parametr ten minimalnie różni się od wymaganych, zapewniają jednak pełną funkcjonalność stołu, dlatego ma potrzeby by realizowane były w inny sposób i w wyższym zakresie.

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu w każdej pozycji wynoszącym 280kg i dodatkowo w centralnym położeniu blatu na poziomie 350kg? Parametry te są w pełni wystarczające dla pełnej funkcjonalności stołu podczas przeprowadzania zabiegów u pacjentów bariatrycznych.

Odp. Nie

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z podstawą o prześwicie wynoszącym 80mm i umożliwiającym całkowite wsunięcie stóp chirurga pod podstawę? Jest to rozwiązanie, zapewniające pełny komfort pracy personelu przez umożliwienie łatwiejszego dostępu do operowanego.



Odp. Nie

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, wyposażony w system antykolizyjny zabezpieczający poszczególne jego elementy przed uszkodzeniem?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2

Czy nie nastąpiła omyłka w określeniu długości roboczej, gdyż endoskop o długości całkowitej 1650 mm, posiada długość roboczą 1330 mm?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak, winno być 1330 mm.

Pytanie 4, dot. wzoru umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy było możliwe wyłącznie za jego zgodą wyrażona na piśmie?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 4, dot. wzoru umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by termin przystąpienia do usunięcia awarii wynosił 72 godziny w dni robocze?

Odp. Nie