



ISO 9001



Akredytacja CMJ

Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

tel. 74/64 89 600
www.zdrowie.walbrzych.pl

fax 74/ 64 89 746
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 02.11.2011 r.

DZPZ-530-Zp/85/PN-75/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę obłóżeń – Zp/85/PN-75/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji tarczycy wykonanego

z miękkiego dwuwarstwowego materiału z obszarami wzmocnionymi o gramaturze 55 g/m^2 ; obszar wzmocnień 110 g/m^2 ; nieprzemakalność $> 150 \text{ cm H}_2\text{O}$ dla obszarów niewzmocnionych

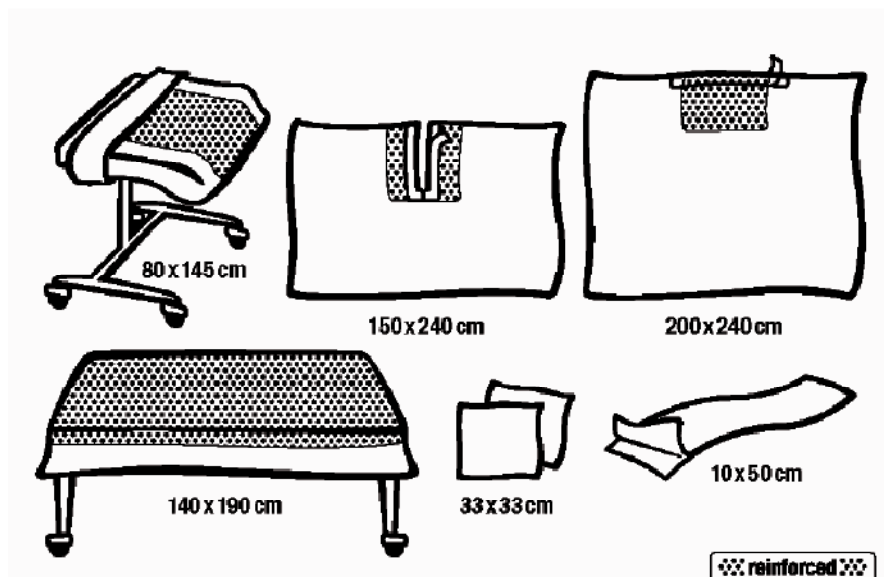
i wzmocnionych, wytrzymałość na rozciąganie na sucho oraz na mokro $> 45 \text{ N/50 mm}$ obszary niewzmocnione i $> 110 \text{ N/50 mm}$ obszary wzmocnione, wytrzymałość na

wypychanie na sucho oraz na mokro > 150

obszary niewzmocnione 300 kPa obszary wzmocnione i następującym składzie:

kPa

i >



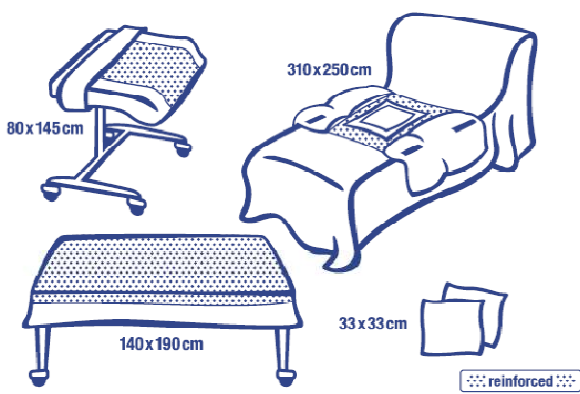
Miejsca wykropkowane – obszary wzmocnione

- 1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm),
- 1 obłożenie stołka Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm),
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 240 cm; wycięcie „U” 6,5 x 60 cm (wzmocnienie 70 x 60 cm),
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm),
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm,
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii w ułożeniu pacjenta na plecach ze zintegrowanymi osłonami na kończyny wykonanego z miękkiego dwuwarstwowego materiału z obszarami wzmocnionymi o gramaturze 55 g/m²; obszar wzmocnień 110 g/m²; nieprzemakalność > 150 cm H₂O dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych, wytrzymałość na rozciąganie na sucho oraz na mokro > 45 N/50 mm obszary niewzmocnione i > 110 N/50 mm obszary wzmocnione, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro > 150 kPa obszary niewzmocnione i > 300 kPa obszary wzmocnione i następującym składzie:

Zestaw do laparoskopii I wzmocniony	
	Skład zestawu:
	1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190
	1 obłożenie stołka Mayo 80 x 145
	1 serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (28 x 32cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250
	2 ręczniki celulozowe 33 x 33

Miejsca wykropkowane – obszary wzmocnione

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu barkowego wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m^2 , nieprzemakalność $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$ i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do artroskopii stawu barkowego 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 1 osłona na kończynę 25 x 80 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150 x 175 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U (6,5 x 60 cm) 200 x 260 1 serweta samoprzylepna (ekran anestetyczny) 150 x 240 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 4 ręczniki celulozowe 33 x 33
--	---

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. dot. pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m^2 , nieprzemakalność $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$ i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw II do zabiegów w chirurgii biodra 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 1 serweta operacyjna 75 x 90 1 serweta operacyjna 150 x 200 1 osłona na kończynę 35 x 120 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U (6,5 x 95 cm) 200 x 260 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 4 ręczniki celulozowe 33 x 33
--	---

Oraz

dodatkowo, pakowana oddzielnie (niezależnie od zestawu) jednosekcyjna kieszeń samoprzylepna o rozmiarze 43 cm x 38 cm?

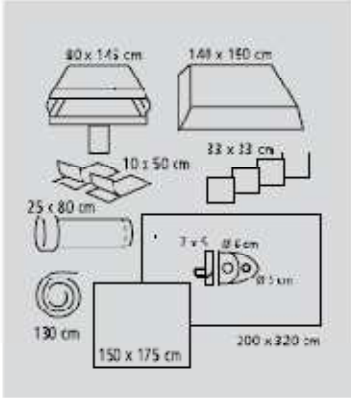
Odp. Tak

Pytanie 5, dot. dot. pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego

z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m^2 , nieprzemakalność $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$

i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do artroskopii	
	1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta nieprzylepna (pod nogę) 1 osłona na kończyne 1 serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów. Posiada samouszczelniające się, elastyczne otwory: $7 \times 5 \text{ cm}$, $\varnothing 5 \text{ cm}$ 1 rurka drenowa 2 taśmy samoprzylepne 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 150 x 175 25 x 80 200 x 320 130 10 x 50 33 x 33

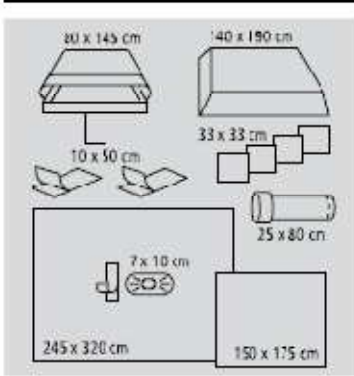
Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego

z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m^2 , nieprzemakalność $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$

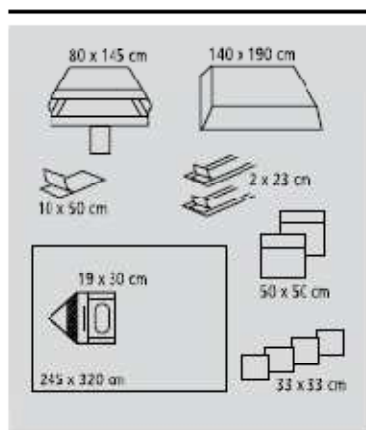
i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw III do zabiegów na kończynie	
	1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta nieprzylepna (podkład pod kończyne) 1 osłona na kończyne 1 serweta do obłożenia kończyny z elastycznym, samouszczelniającym się otworem ($\varnothing 7 \times 10 \text{ cm}$) i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów 2 taśmy samoprzylepne 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 150 x 175 25 x 80 245 x 320 10 x 50 33 x 33

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m^2 , nieprzemakalność $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$ i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do neurochirurgii 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta do obłożenia czaszki z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (19 x 30 cm) i torbą do zbierania płynów (z sitem i zaworem) 2 samoprzylepne serwety operacyjne (do ograniczenia wielkości pola operacyjnego, jeśli wymagane) 2 uchwyty Velcro do mocowania kabli i drenów 1 taśma samoprzylepra 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 245 x 320 50 x 50 2 x 23 10 x 50 33 x 33
---	---	---

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakietu nr 5, poz. 1,6,7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m^2 , nieprzemakalność $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$?

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo w rozmiarze $145 \text{ cm} \times 80 \text{ cm}$ wykonanej z dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 57 g/m^2 (folia); 93 g/m^2 (folia + włóknina); 134 g/m^2 (folia + wzmocnienie) nieprzemakalność $> 150 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 110 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 45 N/50 mm , wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 70 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 40 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro $> 200 \text{ kPa}$?

Odp. Tak

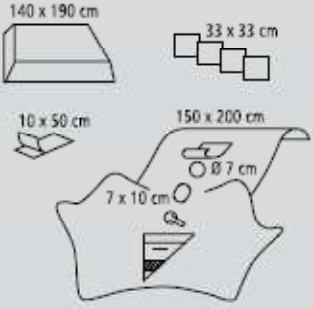
Pytanie 10, dot. pakietu nr 5, poz. 4,5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na kończynę wykonanego z dwuwarstwowego materiału (włóknina/folia) o gramaturze 70 g/m^2 , nieprzemakalność $> 150 \text{ H}_2\text{O}$, odporność na rozciąganie na sucho oraz mokro w kierunku podłużnym 60 N/50 mm , w kierunku poprzecznym 50 N/50 mm , wytrzymałość na wypychanie na sucho $> 100 \text{ kPa}$, na mokro $> 50 \text{ kPa}$?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakietu nr 6, poz. 1

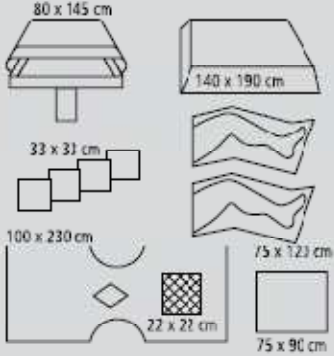
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji urologicznych ze zintegrowanymi osłonami na kończyny wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O , wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do urologii 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta urologiczna z nadłonowym samoprzylepnym okienkiem (Ø 7cm), z samoprzylepnym oknem na narządy płciowe (7 x 10 cm), osłoną na palec i torbą do zbierania płynów (z sitem) 1 taśma samoprzylepna 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 150 x 200 10 x 50 33 x 33
---	--	--

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii wykonanego z trzywarstwowej włókniny o gramaturze 74 g/m², nieprzemakalność > 200 cm H₂O , wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 100 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku podłużnym 80 N/50 mm, w kierunku poprzecznym 35 N/50 mm, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz mokro > 200 kPa i następującym składzie:

	Foliodrape® Zestaw I do procedur przecewkowych (TUR) 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 1 serweta operacyjna 1 serweta z oknem (8 x 12 cm) i sitem (22 x 22 cm) 2 osłony na nogi długie 4 ręczniki celulozowe	140 x 190 80 x 145 75 x 90 100 x 230 75 x 120 33 x 33
---	---	--

Odp. Tak

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*